

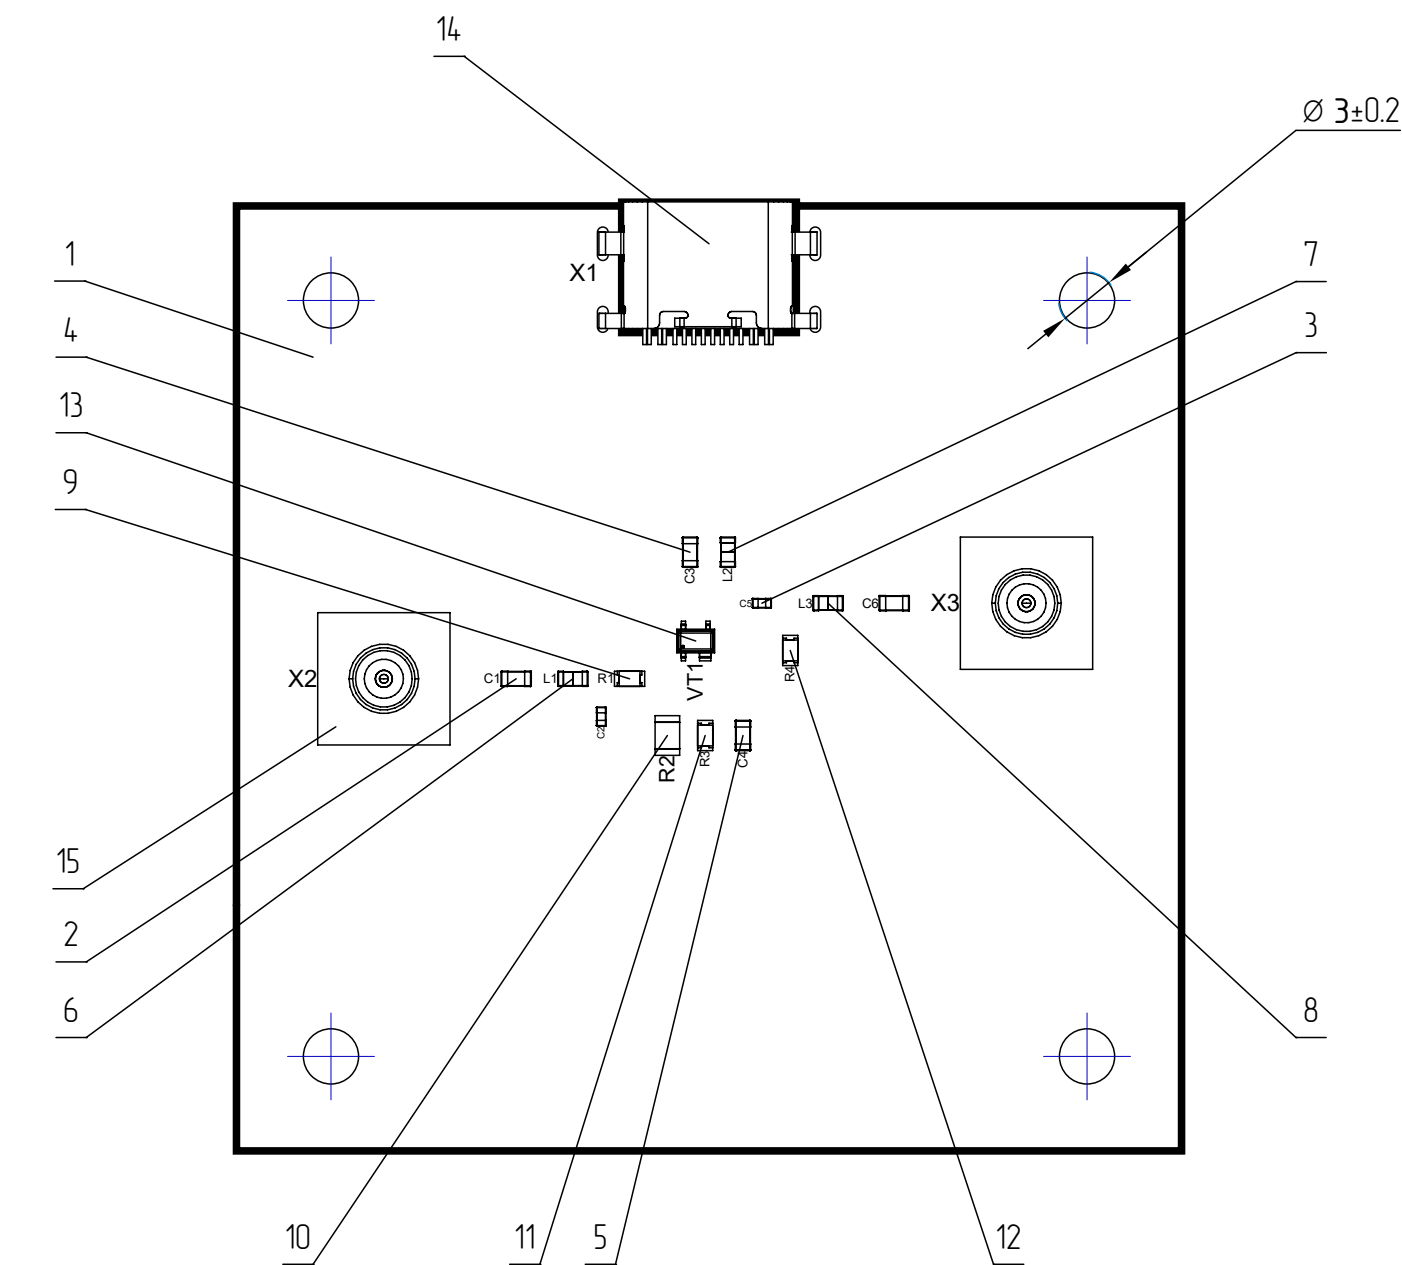


ДК11.75076.001СК

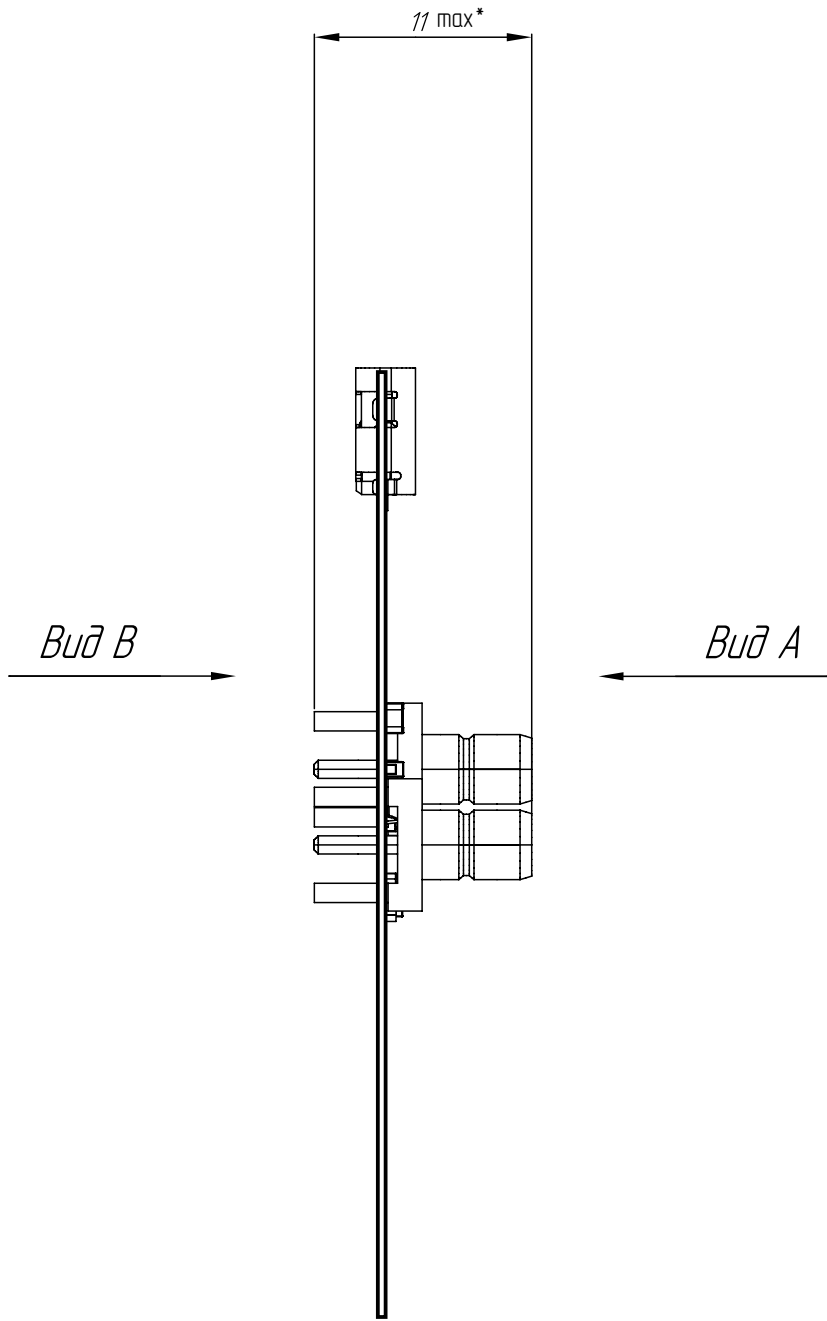


Вид А
(ізометричний вигляд)

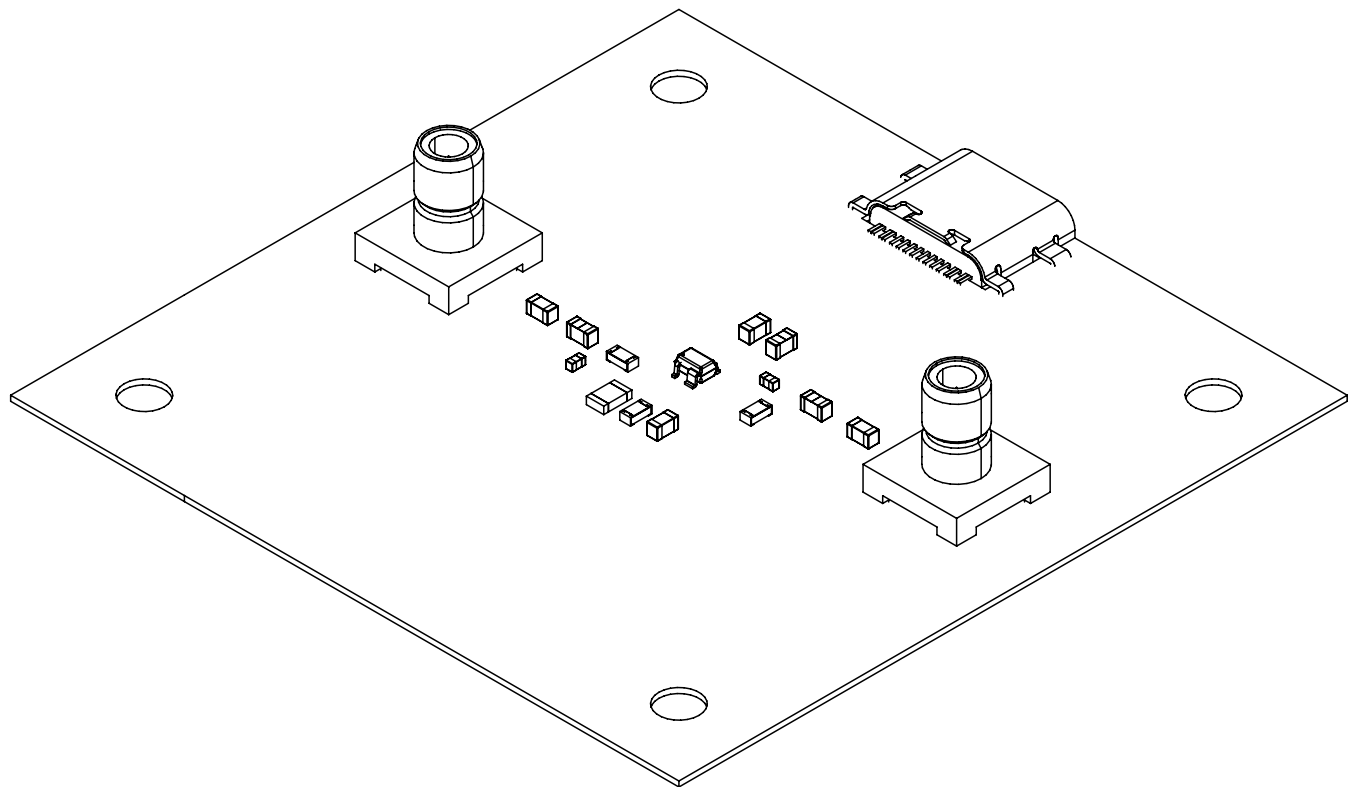



*Розміри для довідки

- Компоненти встановлювати згідно з ГОСТ 29137–91.
- Електромонтажу виконувати відповідно до схеми з'єднання.
- Допускається закруглення кутів контактних площадок та провідників.
- Крок координатної сітки — 0,5 мм.
- Всі висновки компонентів паяти припоєм ПОС-61 згідно з ГОСТ 21930–76.
- Після монтажу всіх компонентів та попереднього захисту зон охолодження нанести лак ПЛАСТИК-71 згідно з ГОСТ 16506–71.

					ДК11.75076.001СК				
Зм.	Арк.	№ докум.	Підп.	Дата	Малошумний високочастотний підсилювач для лабораторного стенду		Літ.	Маса	Маштаб
Розроб.		Матиаш Е. В.			Складальне креслення		0		23 г 4:1
Перев.		Гудар В.Г.							
							Арк. 1		Архив 2
Н.контр.		Гудар В.Г.			КПІ ім. Ігоря Сікорського ФЕЛ, ДК-11				
Затв.		Бондаренко В.М.							

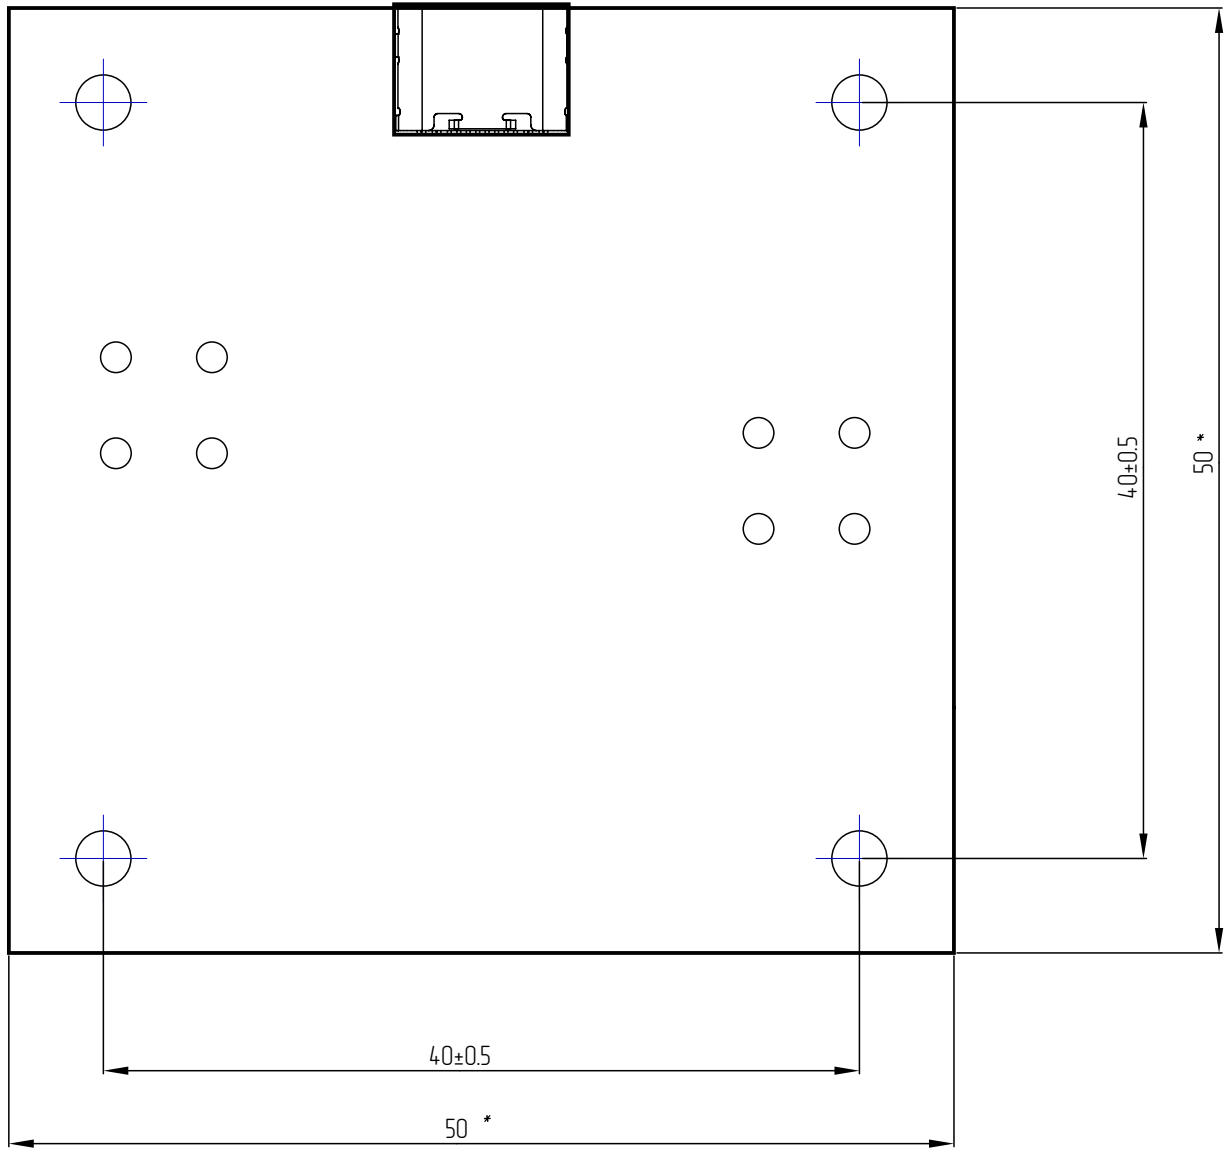

Вид В
(ізометричний вигляд)

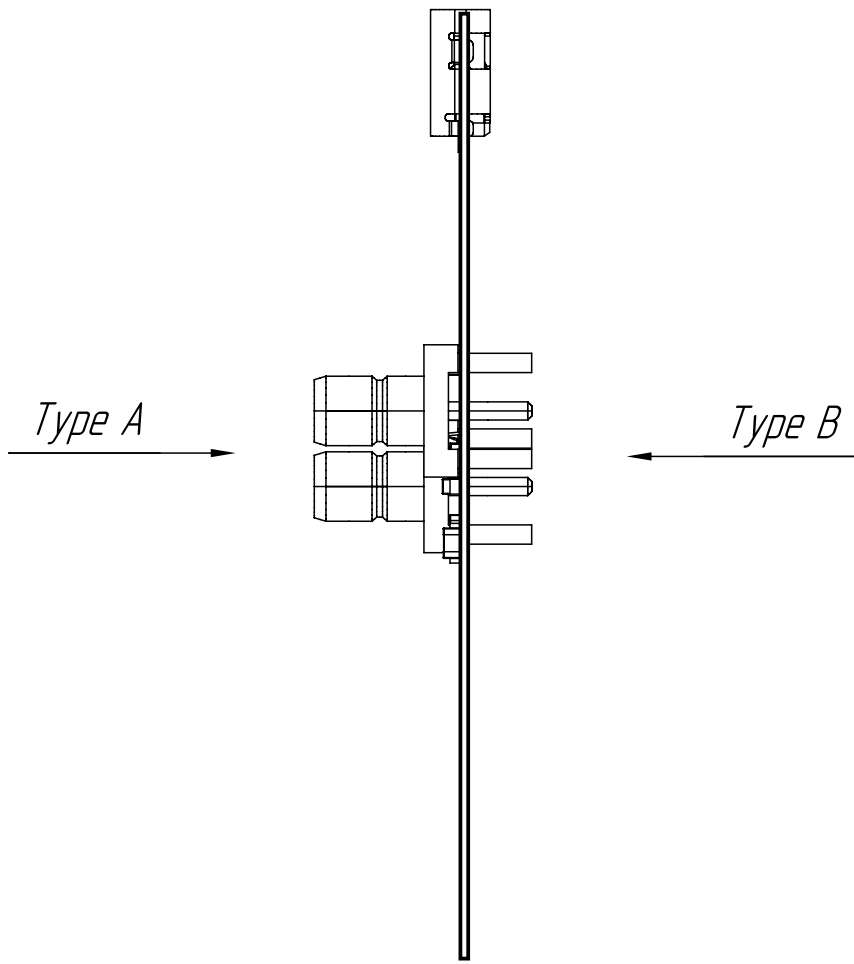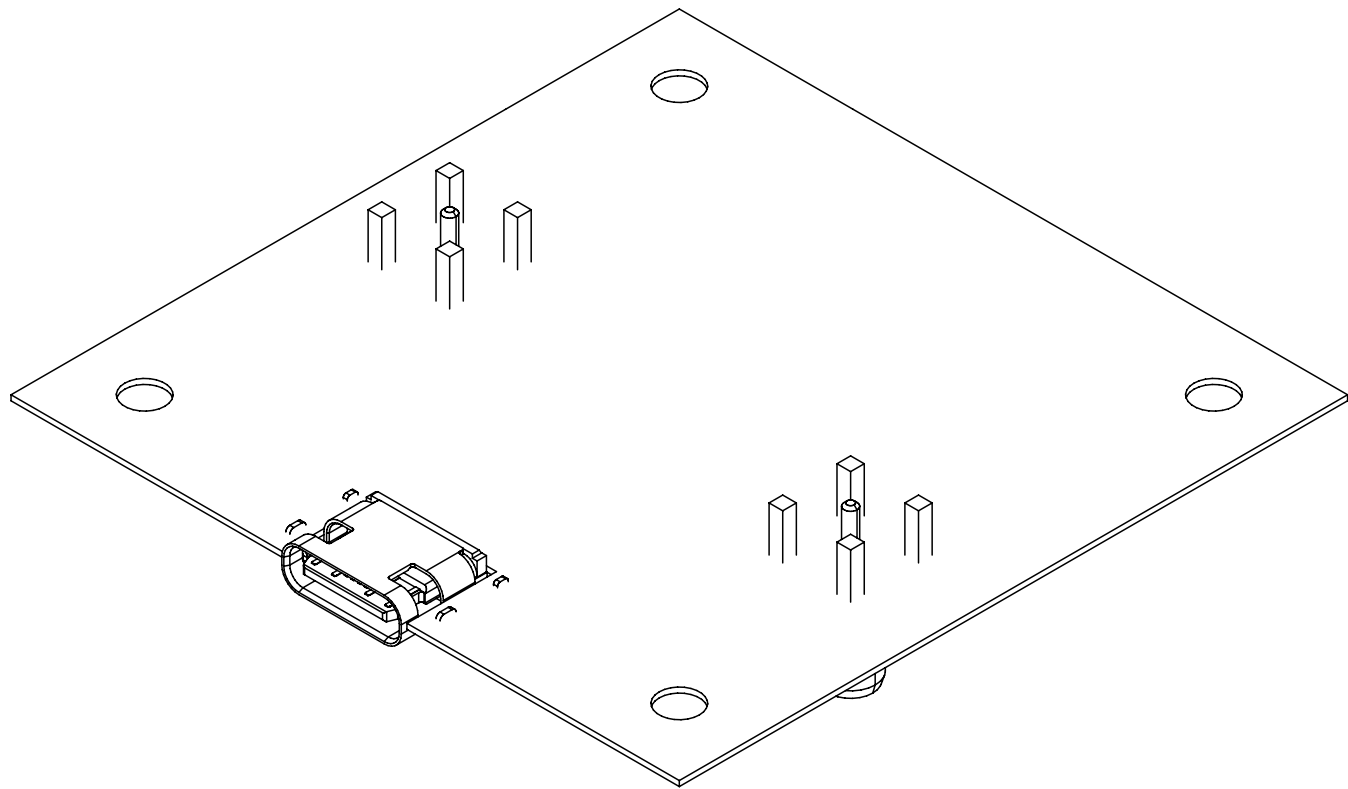

Вид В
(ізометричний вигляд)

